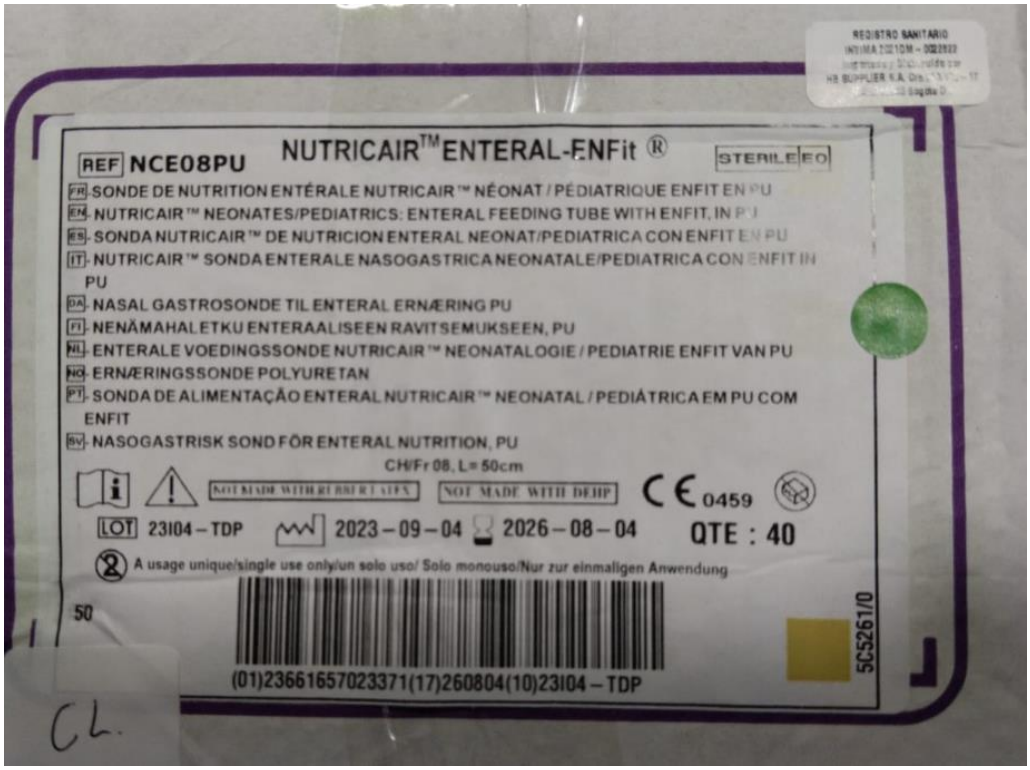
REF NCE08PU
NUTRICAIR™ENTERAL-ENFit ®
STERILE EO
FR - SONDE DE NUTRITION ENTÉRALE NUTRICAIR™ NÉONAT / PÉDIATRIQUE ENFIT EN PU
EN - NUTRICAIR™ NEONATES/PEDIATRICS: ENTERAL FEEDING TUBE WITH ENFIT, IN PU
ES - SONDA NUTRICAIR™ DE NUTRICION ENTERAL NEONAT/PEDIATRICA CON ENFIT EN PU
IT - NUTRICAIR™ SONDA ENTERALE NASOGASTRICA NEONATALE/PEDIATRICA CON ENFIT IN PU
DA - NASAL GASTROSONDE TIL ENTERAL ERNÆRING PU
FI - NENÄMAHALETKU ENTERAALISEEN RAVITSEMUKSEEN, PU
NL - ENTERALE VOEDINGSSONDE NUTRICAIR™ NEONATALOGIE / PEDIATRIE ENFIT VAN PU
NO - ERNÆRINGSSONDE POLYURETAN
PT - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRICAIR™ NEONATAL / PEDIÁTRICA EM PU COM ENFIT
SV - NASOGASTRISK SOND FÖR ENTERAL NUTRITION, PU
CH/Fr 08, L= 50cm
NOT MADE WITH RUBBER LATEX
NOT MADE WITH DEHP
CE 0459
LOT 23I04 – TDP
2023 – 09 – 04
2026 – 08 – 04
QTE : 40
A usage unique/single use only/un solo uso/ Solo monouso/Nur zur einmaligen Anwendung
50
(01)23661657023371(17)260804(10)23I04 – TDP
5C5261/0
CL.

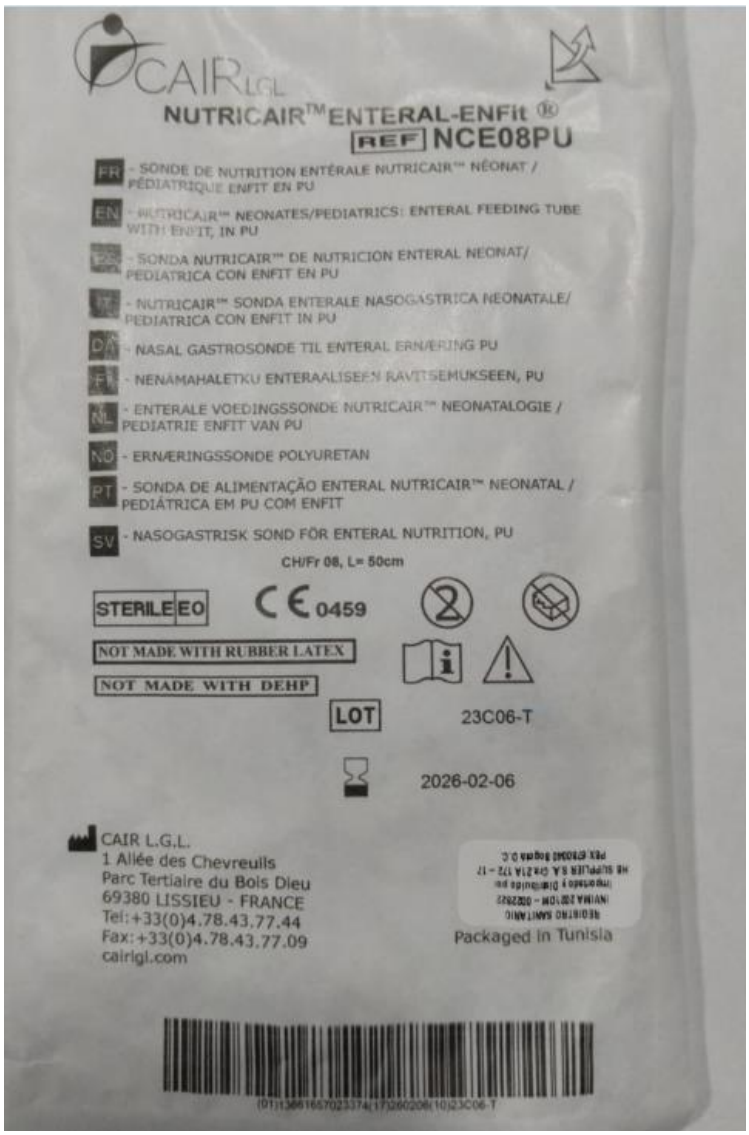
CAIR LGL
NUTRICAIR™ENTERAL-ENFit ®
REF NCE08PU
FR - SONDE DE NUTRITION ENTÉRALE NUTRICAIR™ NÉONAT / PÉDIATRIQUE ENFIT EN PU
EN - NUTRICAIR™ NEONATES/PEDIATRICS: ENTERAL FEEDING TUBE WITH ENFIT, IN PU
ES - SONDA NUTRICAIR™ DE NUTRICION ENTERAL NEONAT/ PEDIATRICA CON ENFIT EN PU
IT - NUTRICAIR™ SONDA ENTERALE NASOGASTRICA NEONATALE/ PEDIATRICA CON ENFIT IN PU
DA - NASAL GASTROSONDE TIL ENTERAL ERNÆRING PU
FI - NENÄMAHALETKU ENTERAALISEEN RAVITSEMUKSEEN, PU
NL - ENTERALE VOEDINGSSONDE NUTRICAIR™ NEONATALOGIE / PEDIATRIE ENFIT VAN PU
NO - ERNÆRINGSSONDE POLYURETAN
PT - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRICAIR™ NEONATAL / PEDIÁTRICA EM PU COM ENFIT
SV - NASOGASTRISK SOND FÖR ENTERAL NUTRITION, PU
CH/Fr 08, L= 50cm
STERILE EO
CE 0459
NOT MADE WITH RUBBER LATEX
NOT MADE WITH DEHP
LOT 23C06-T
2026-02-06
CAIR L.G.L.
1 Allée des Chevreuils
Parc Tertiaire du Bois Dieu
69380 LISSIEU - FRANCE
Tel:+33(0)4.78.43.77.44
Fax:+33(0)4.78.43.77.09
cairigl.com
Packaged in Tunisia

REF: NCE08PU