


SISTEMA HEMOLOCK

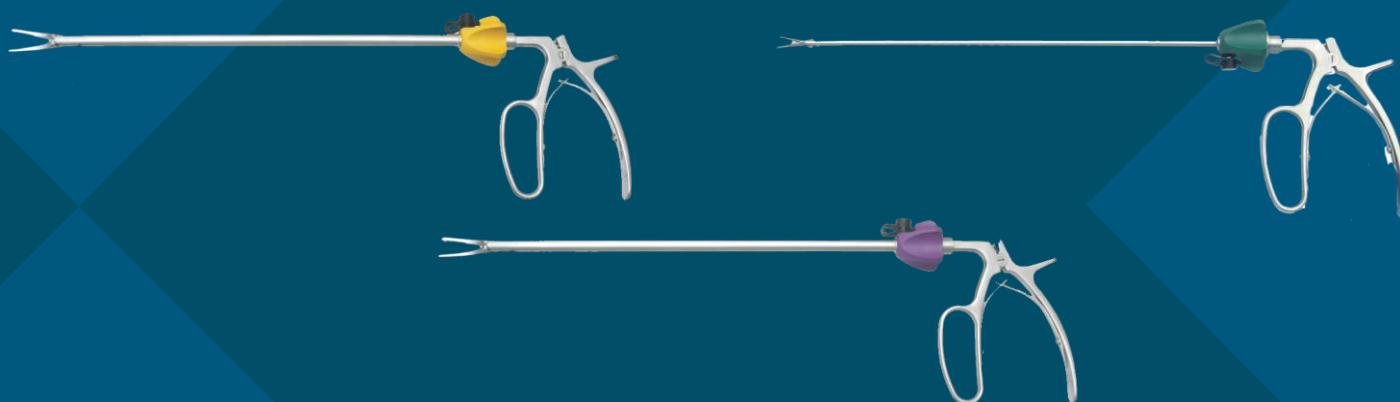

Nombre producto: PINZA CLIP HEMOLOCK

Marca: LOMI

Registro sanitario: INVIMA 2020DM-0022598

Importado por: Todo Ortopédico SAS

Material: acero inoxidable

Esterilización: dispositivo reutilizable, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso.

Método de esterilización: Vapor 135°-
OE

Uso: en procedimiento por video-laparoscopia (cirugía general, ginecología, urología, cirugía de tórax),

MEDIDAS: 10MM X 330MM Ref. PZD801113 acción única
10MM X 330MM Ref. PZM8011131 acción única
5MM X 330MM Ref. PZS8011132 acción única



www.todoortopedico.co.com