


FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

FICHA TÉCNICA No. FTDM-113V00

GRAVISET BAG

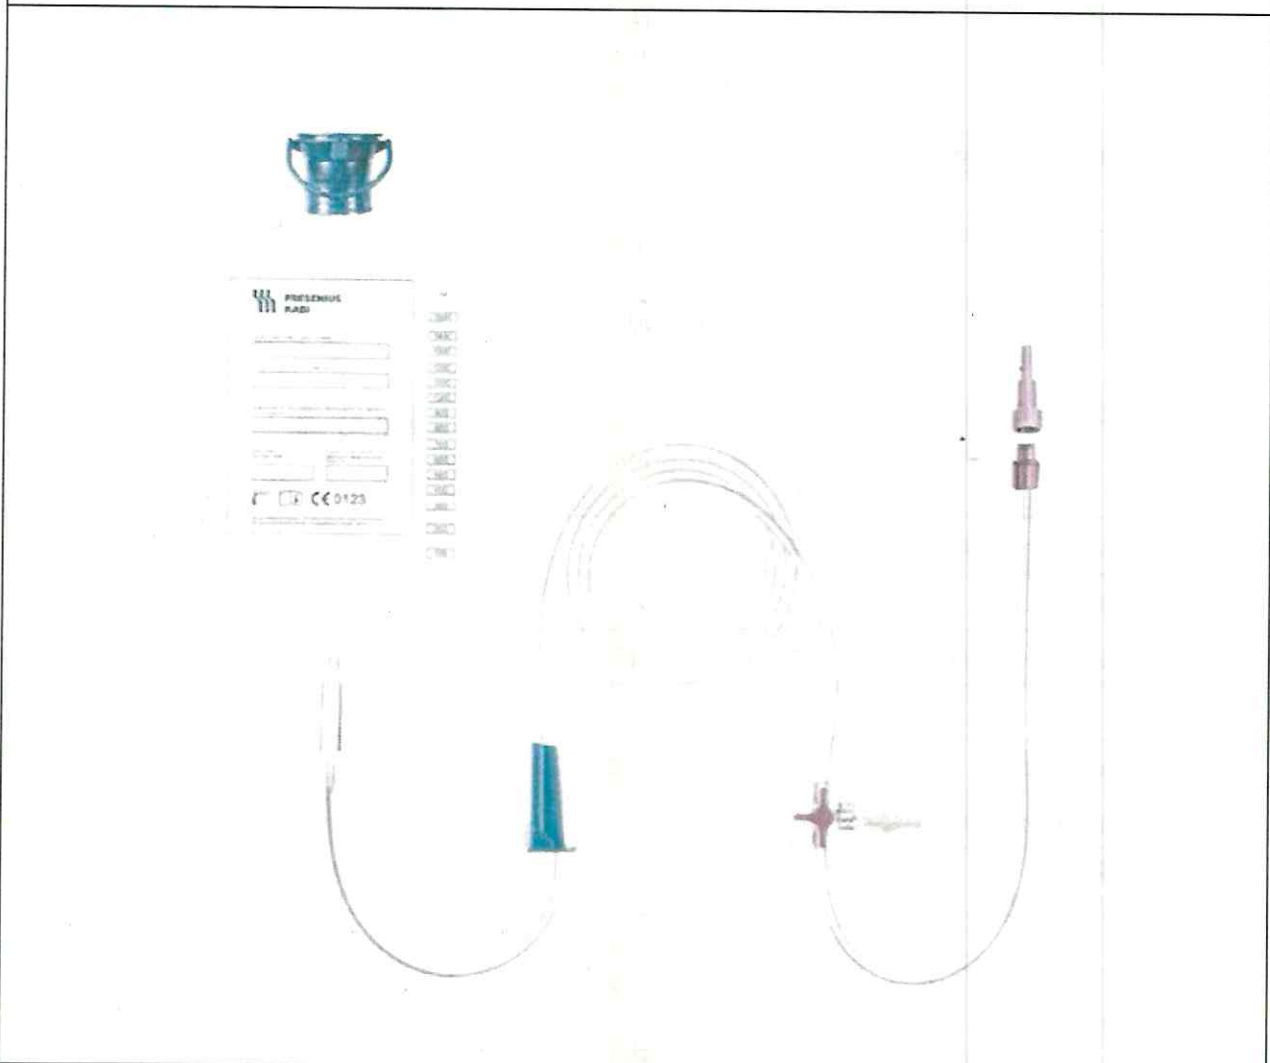


INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del producto	GRAVISET BAG
Referencia	7751954

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

Descripción	Dentro de los componentes que hacen parte de la línea, se encuentran: una cámara de goteo, una pinza de rodillo, Llave de paso ENFit, ENFit hembra Oral / LL hembra Conector, ENFit macho-ENLOCK, Conector universal ENFit Masculino - LL Femenino
Presentación comercial	30 Unidades
Marca	Fresenius Kabi
Uso o Destino	Set para nutrición enteral, utilizado en la alimentación por sonda.
Características Especiales	Tubo con capa compuesta: 4,9 x 6,5 x 40 ± 5 mm cm Conector Proximal: LL/ENL Pieza T: LL/ENL/Oral Conector proximal con tapa: LL: LuerLock ENL: ENLock
Clasificación del Riesgo	IIA
Tipo de Dispositivo	No invasivo
Registro sanitario INVIMA	INVIMA 2014DM-0011632
Tiempo de Vida Útil	36 meses
Fecha Resolución	Resolución 2014022161 de 17 de julip 2014
Fecha vencimiento Registro	06/08/2024
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura ambiente
Titular	FRESENIUS KABI AG Alemania
Fabricante	FRESENIUS KABI AG FRESENIUS KABI (NANCHANG) CO., LTD CLINICO MEDICAL SP. Z.O.O
Importador	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. Av Cra 7 No. 155C-20 North Point Torre E piso 40

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

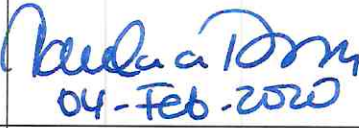Origen	Alemania	
DATOS ADICIONALES		
Característica	El conector de transición, solo se debe usar con ese conjunto, deseche el conector de transición, junto con este conjunto, no lo utilice junto con conjuntos	
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 04 Feb 2020	 04 FEB. 2020	 04-Feb-2020
Pilar Vega Bejarano Analista de Asuntos Regulatorios	Johanna Ramirez Gerente de Producto Application Devices	Paula Andrea Parra Vargas Gerente de Asuntos Regulatorios

