




Medline Industries Ltd
Three Lakes Dr, Northfield, IL 60093,
Estados Unidos
www.medline.com

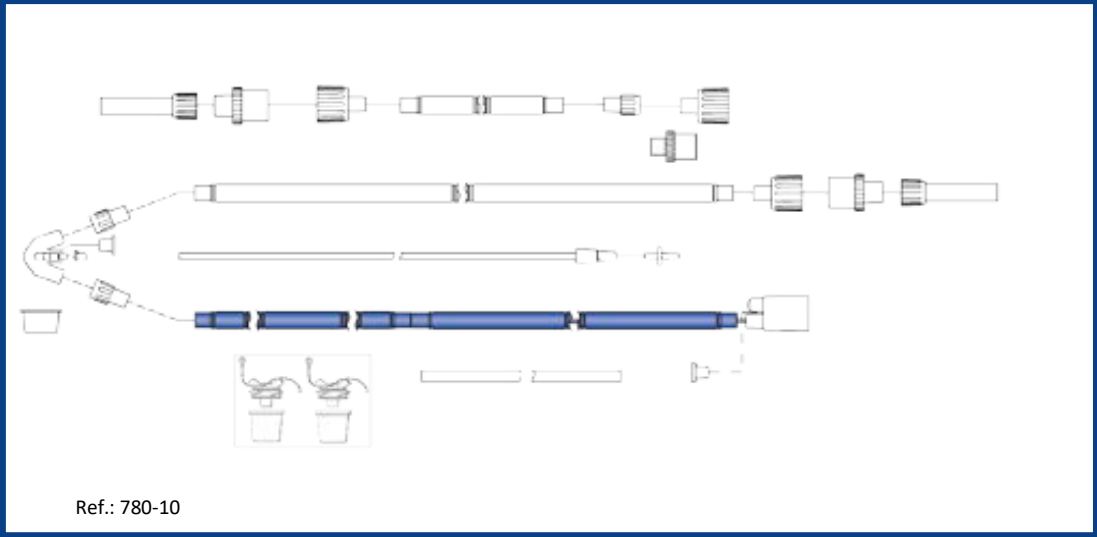

FICHA TECNICA

Circuitos convencionales Neonatales

Producto	CIRCUITOS DE VENTILACION Y ACCESORIOS
Marca	HUDSON RCI, CORR-A-TUBE
Registro Sanitario	INVIMA2019DM-0019216
vigencia registro	08/01/2029 (10 años)
Fabricante	TELEFLEX MEDICAL INC, MEDLINE INDUSTRIES, LP
Pais de origen	Mexico, EE UU
Fecha emisión registro	08/01/2019
Expediente	20156796
Tipo de dispositivo	Invasivo
Riesgo	IIA
GMDN	37706
Presentación	Caja : 20,10,15,50 unidades
Vida util	5 años, uso único por paciente
Usos	Sistemas diseñados para suministrar ventilación de apoyo parcial o total desde un ventilador mecánico a un paciente
Componentes	Adaptadores, tubos corrugados, colectores agua, tubo monitorización presión, Unión en Y.
Material componentes	Polipropileno, Acrílico, EVA, PVC. Libre de latex
Condiciones de almacenamiento	Condiciones generales de almacenamiento

Referencia	Descripcion dispositivo en IDM	codigo IDM
780-10	Universal Neonatal Ventilator Circuit with Proximal Temperature Port /Circuito neonatal universal con puerto de temperatura proximal	4026704598038
780-11	Universal Neonatal Ventilator Circuit with remoteTemperature Port. /Circuito neonatal universal con puerto de temperatura remoto	4026704598045
780-12	Breathing Circuit (10mm). /Circuito respiratorio 10mm	4026704398393

Referencias y configuracion :

CÓDIGO DE ARTÍCULO	CONFIGURACIONES DE CIRCUITOS												
	RAmA	SONDAS	H-IL	H-EL	IL-TRAP	EL-TRAP	H LImb	TPA	Válvula E	LONGITUD	PmT	RTP	NOTAS
780-10	Doble	10 mm			•	•	•			48 in	•		Dos colectores de agua individuales
780-11	Doble	10 mm			•	•	•			48 in	•	•	Dos colectores de agua individuales
780-12	Doble	10 mm			•	•	•			48 in	•	•	

Claves de matriz de los circuitos:
H-IL = rama inspiratoria caliente, H-EL = rama espiratoria caliente, IL-TRAP = colector de agua de rama inspiratoria, EL-Trap = colector de agua de ramaespiratoria, RTP = puerto de control de temperatura remoto, PMT = sonda de control de presión, H-LIMB = rama del humidificador

Descripción

Los circuitos utilizan tubos de 10 mm, incluyen dos líneas de presión e incorporan conectores estándar de 15 mm y 22 mm
Los conectores de puertos permiten monitorizar la presión y la temperatura e incluyen tapones de sujeción
Todos los circuitos convencionales neonatales tienen 48 pulgadas de longitud (120cms aprox)
Todos los circuitos neonatales incluyen una rama de humidificación
Disponible con 2 trampas de agua (ensambladas o separadas)

Materiales principales

PVC, criolita acrílica, plexiglás acrílico, Versaflex, PP, PE, EVA

Cantidad por caja

20 unidades

Envasado


Bolsa de polietileno (PE)

Fabricante

Teleflex Medical 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560 USA – ISO 13485


Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Productos sanitarios IIa
Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

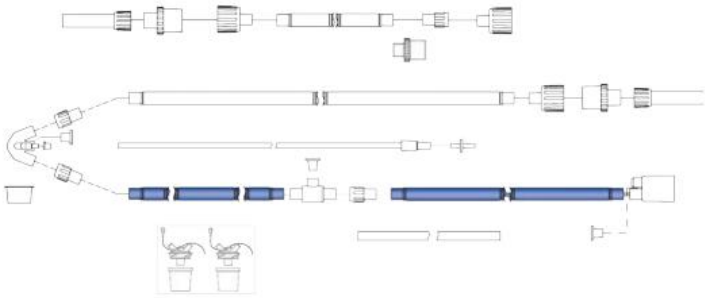


Código de artículo 780-11

- Circuito de ventilación neonatal estándar con puertos de temperatura remotos de 18 in y proximales y colectores de agua individuales.

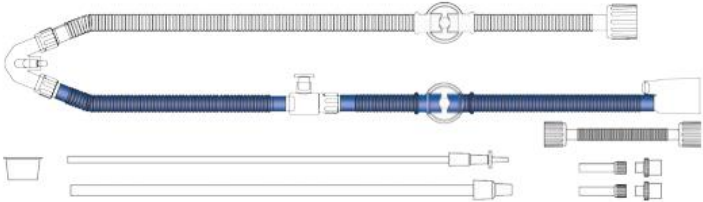

Código de artículo 780-12

- Circuito neonatal estándar con colectores de agua ensamblados.
- Puertos de temperatura remotos de 18 in y proximales.

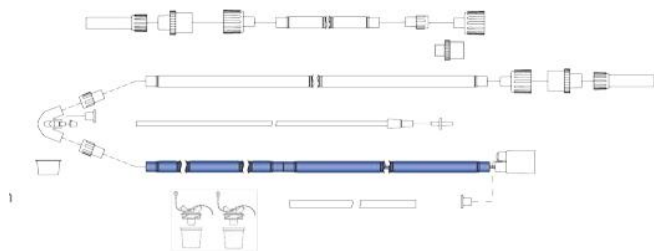

Código de artículo 780-10

- Circuito de ventilación neonatal estándar con puerto de temperatura proximal y colectores de agua individuales.



1639

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. TDS_
Neonatal_Conventional_Circuit_Non_Sterile_ES01

Número de documento: EU1-00004-F-