

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-534	Grupo de Marca	12600
Descripción	CUTIMED SILTEC		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2018DM-0018020		
País Fabricante	ALEMANIA		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL Y CÓDIGO DE BARRAS. SE DEBE ACONDICIONAR CADA UNIDAD Y SUB-EMPAQUE		
UNIDAD DE VENTA	SUB-EMPAQUE (PLEGADIZA)		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Técnico Legal	N/A	SI	SI
Código de Barras	N/A	SI	SI
Condiciones de Acondicionamiento	TAPAR CÓDIGO DE BARRAS EAN 12 Y COLOCAR EL STICKER SOBRE LOS CÓDIGOS DE BARRAS		

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-venimiento (Años)	1 ½
Vencimiento (Años)	3

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA	
Se incluye fotos en ANEXO	

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos								
BNR	NART	Descripción		Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Códigos de barras			Contenido Uds		
				Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempa	Individual
73285-00	73285-00000-00	CMED SLC STE 5X6CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	394	298	200	138	74	165	119	35	2	1450	102	5	4042809555868	4042809555851	7707331803142	10	10	1 SOBRE
73285-00	73285-00000-01	CMED SLC STE 5X6CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	394	298	200	138	74	165	119	35	2	1450	102	5	4042809555868	4042809555851	7707331803142	10	10	1 SOBRE
73285-01	73285-00001-00	CMED SLC STE 10X10CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	405	389	244	188	74	209	165	35	2	2587	200	13	4042809556124	4042809556100	7707331803159	10	10	1 SOBRE
73285-01	73285-00001-01	CMED SLC STE 10X10CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	405	389	244	188	74	209	165	35	2	2587	200	13	4042809556124	4042809556100	7707331803159	10	10	1 SOBRE
73285-02	73285-00002-00	CMED SLC STE 10X20CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	394	394	344	185	74	309	163	35	2	4067	332	18	4042809556346	4042809556339	7707331803166	10	10	1 SOBRE
73285-02	73285-00002-01	CMED SLC STE 10X20CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	394	394	344	185	74	309	163	35	2	4067	332	18	4042809556346	4042809556339	7707331803166	10	10	1 SOBRE
73285-03	73285-00003-00	CMED SLC STE 15X15CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	499	389	290	235	74	255	216	35	2	4287	351	25	4042809556360	4042809556353	7707331803173	10	10	1 SOBRE
73285-03	73285-00003-01	CMED SLC STE 15X15CM 10 INT. (N. diseño)	N/A	499	389	290	235	74	255	216	35	2	4287	351	25	4042809556360	4042809556353	7707331803173	10	10	1 SOBRE
73285-04	73285-00004-00	CMED SLC STE 20X20CM 5 INT. (N. diseño)	N/A	461	393	333	295	49	326	275	10	2	4223	340	30	4042809556414	4042809556407	7707331803180	5	5	1 SOBRE
73285-04	73285-00004-01	CMED SLC STE 20X20CM 5 INT. (N. diseño)	N/A	461	393	333	295	49	326	275	10	2	4223	340	30	4042809556414	4042809556407	7707331803180	5	5	1 SOBRE

Información del Sticker Técnico Legal	
Cutimed® Siltec® – Apósito absorbente	
Fabricado por: BSN Medical GmbH , Alemania	
Importado y distribuido por:	
BSN MEDICAL LIMITADA	
Cra. 36 No. 13-451 Yumbo- Valle, Colombia	
Reg. San. INVIMA 2018DM-0018020	
Composición: Película de poliuretano de color azul claro y elástico, espuma de poliuretano flexible de color blanco con bandas absorbentes, capa perforada de silicona grado médico. Película de polietileno transparente y en relieve grado médico.	
Indicaciones y usos: Apósito estéril superabsorbente indicado para el tratamiento de heridas exudativas tales como: úlceras venosas y arteriales, úlceras por presión, gangrenas diabéticas, incisiones quirúrgicas, injertos cutáneos, zonas donantes, laceraciones y abrasiones. Recomendado para heridas con un nivel de exudación de bajo a alto.	
Puede ayudar a prevenir las úlceras por presión, también conocidas como Lesiones Por Presión “LPP”	
Precauciones y advertencias: No utilizar con soluciones oxidantes como el hipoclorito o el peróxido de hidrógeno. Sólo para uso externo.	
Contraindicaciones: No utilizar el producto en pacientes con sensibilidad conocida a uno de sus componentes.	
Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol.	
Método de desecho: El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.	
UTILIZAR UNA SOLA VEZ	
 CODIGO DE BARRAS	

ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			Fecha			Revision No.
									Día	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ			DIANA MARCELA MONTES			IGNACIO MARTINEZ			26	09	2022	10
ANALISTA DE LOGISTICA			SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST			GERENTE TECNICO, ASUNTOS REGULATORIOS Y PRODUCCIÓN PARCHÉ						
Fecha			Fecha			Fecha						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año				

ANEXO No. 1/3

CMED SLC STE 5X6CM 10 INT



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD




MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

CMED SLC STE 10X10CM 10 INT



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA

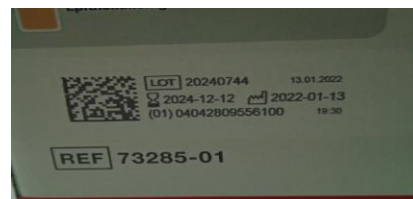

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm


ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD




MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ANEXO No. 2/3

CMED SLC STE 10X20CM 10 INT

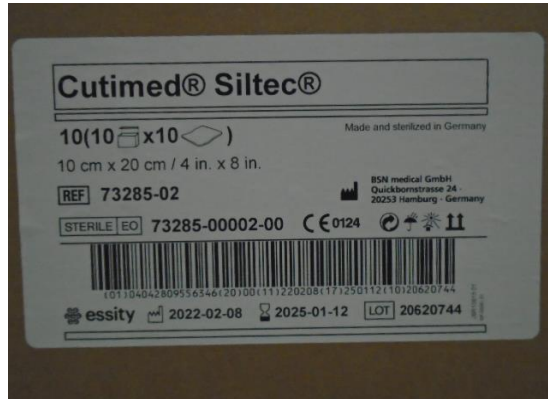

ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA

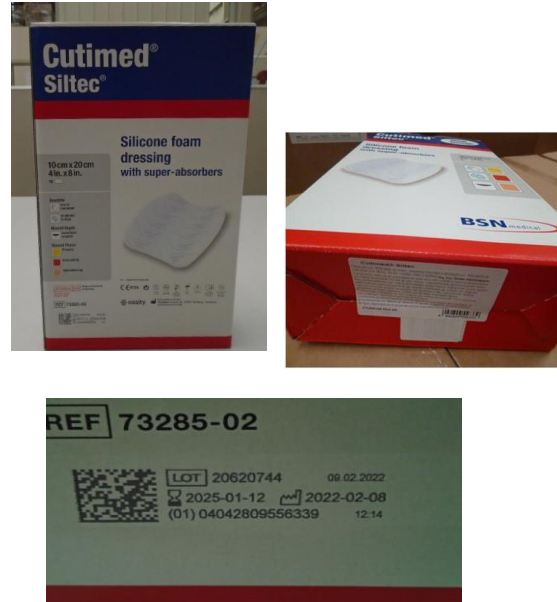

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

CMED SLC STE 15X15CM 10 INT



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

CMED SLC STE 20X20CM 5 INT



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm